THE RICHWAY GROUP

最先端技術

アメジスト バイオマット プロフェッショナル

健康と幸福のために

Richway International Inc.
Fuji Bio Science Inc.
Richway & Life Japan Corp.
R&L Corporation
The Life Co., Ltd.

RICHWAY

biomat 7000mx

JAPANESE
日本語
ESPAÑOL

バイオマットのユーザーガイドです。
遠赤外線とマイナスイオンを発生する
バイオマットの使用方法について詳しく
説明しています。

RICHWAY & LIFE JAPAN CORPORATION
2-6-41 NAKAHATA, ONOJO-SHI, FUKUOKA, JAPAN 816-0921 TEL: +81-92-575-1004 FAX: +81-92-575-1006

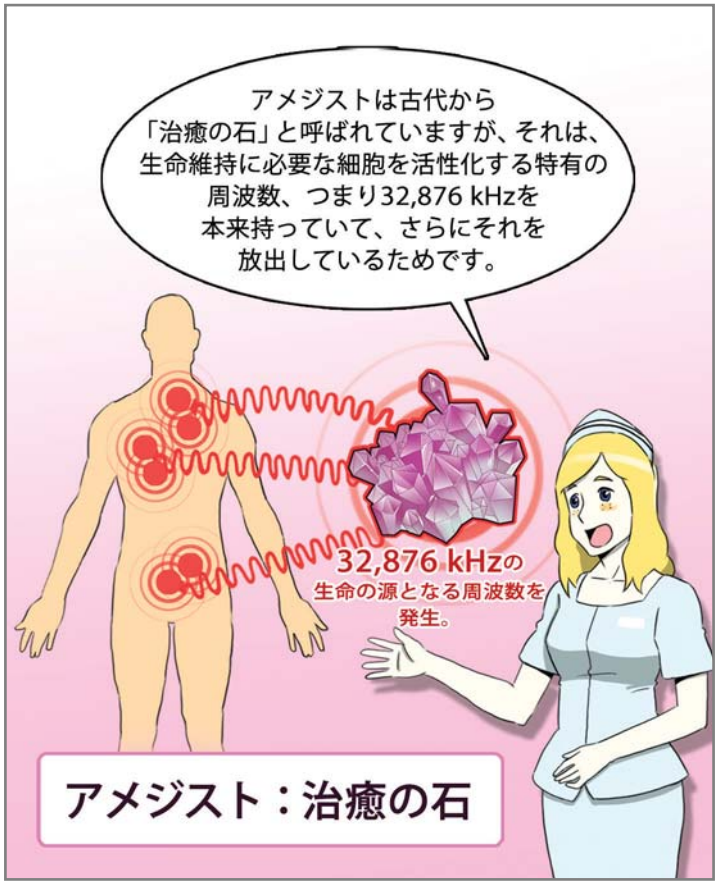

温熱療法は、病気から身を守る強力な武器。

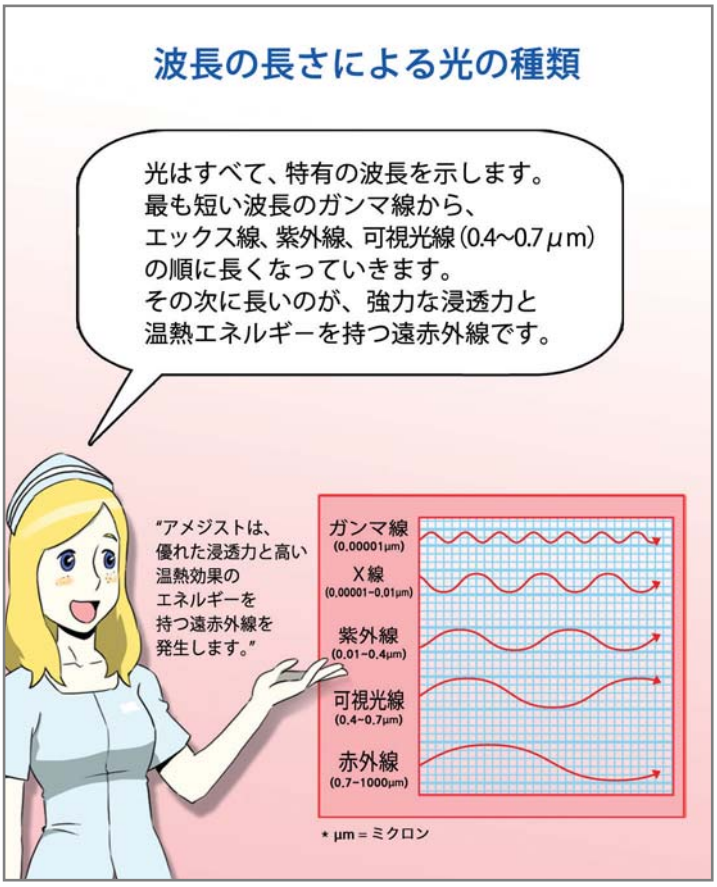

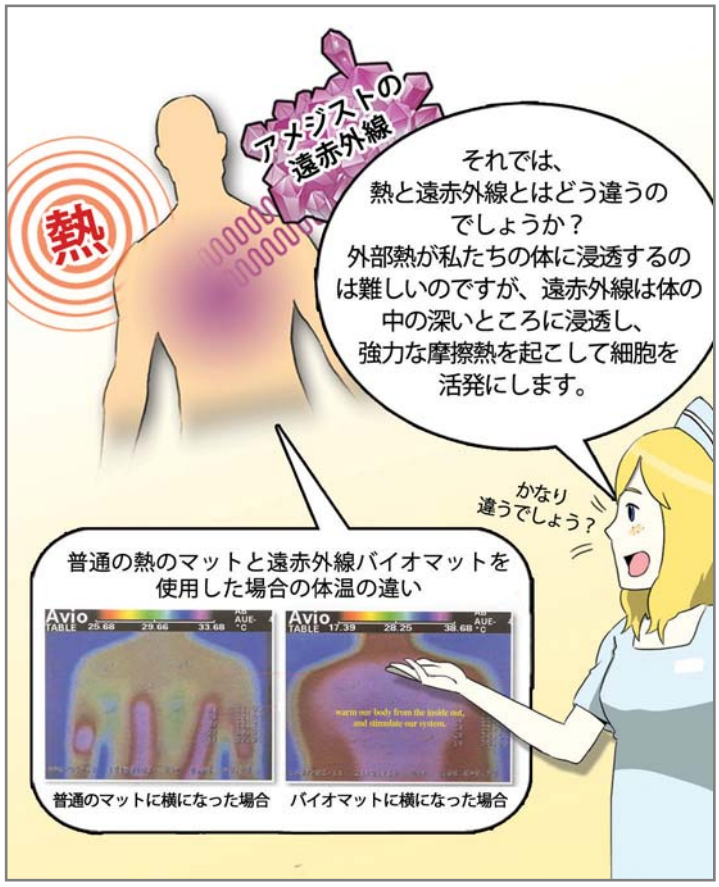

遠赤外線は、世界中で最も安全なエネルギーであり、命の光でもある。（ファン・サン医師、1995年）

バイオマットの優れた保温効果

バイオマットは、体を温め、その体温を長時間保てるようにします。細胞内のミトコンドリアを刺激し、自ら熱を発散できるように体質を変えてくれるからです。

“優れた保温特性のある人体共鳴波長遠赤外線 6.5~9.32 ミクロン。”

米国Telesum によるバイオマット試験データ

後頭部の低体温の部分に設置 (113°F/45°C)		胴辺りの低体温の部分に設置 (113°F/45°C)	
時間	温度	時間	温度
0 秒	24.4℃	0 秒	24.4℃
30 秒	26.6℃	30 秒	26.6℃
60 秒	24.5℃	60 秒	24.5℃
90 秒	26.6℃	90 秒	26.6℃
1 時間	27.6℃	1 時間	27.6℃
バイオマットの電源を切った後の体温変化		バイオマットの電源を切った後の体温変化	
2 時間	26.1℃	2 時間	33.9℃
4 時間	26.7℃	4 時間	33.8℃
6 時間	27.9℃	6 時間	34.5℃
8 時間	27.3℃	8 時間	34.7℃

*バイオマットの電源を切ってから8時間が経過しても体温は維持されています。

バイオマットの使用前　　バイオマットの使用2週間後

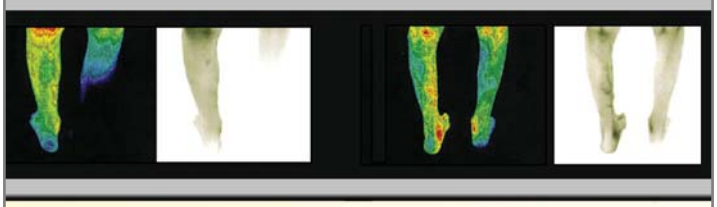

次に、血液循環疾患患者の画像を見てみましょう。バイオマットの使用後、患者の血液循環は、かなり改善されていることが分かります。これは、患者の体質が変化して、以前より高い体温を維持できるようになったからです。

“血液循環を促進する人体共鳴波長遠赤外線 6.5~9.32 ミクロン”

ジョージ・グラント医師

高体温を維持することで自ら体質を変えるという利点は、バイオマットによる温熱療法の最大の特長です。こうして、血液循環が促進され、3000種以上もの必須酵素が活性化されて、体内の有害物質は自然に排出されます。

アメジストの遠赤外線による血液浄化作用

バイオマット使用前　　バイオマット使用30分後

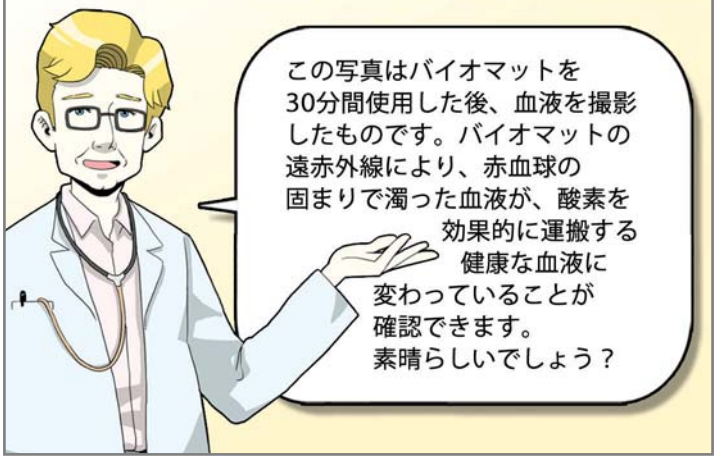

この写真はバイオマットを30分間使用した後、血液を撮影したものです。バイオマットの遠赤外線により、赤血球の固まりで濁った血液が、酸素を効果的に運搬する健康な血液に変わっていることが確認できます。素晴らしいでしょう?

優秀な外科医は、ワシの鋭い目と、ライオンの強い心と、貴婦人の繊細な手をしていなければならない。(イギリスの格言)

心臓の活動を強化するバイオマットの温熱療法

バイオマット使用前
(2010年5月29日)

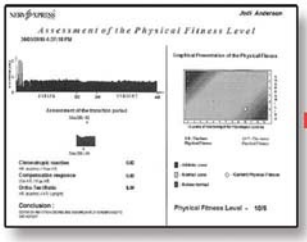

バイオマット使用30分後
(2010年5月29日)

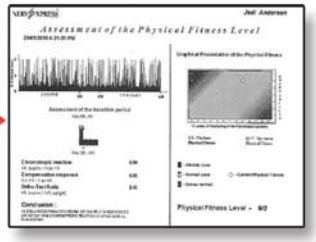

この画像は、57歳の女性の心臓の状態を表したものです。この方は、血管機能の低下や不整脈がみられ、健康状態は良くありませんでした。ところが、バイオマットを30分使用しただけで心臓血管系の活動が驚くほど良くなりました。このように、遠赤外線の温熱療法は、私たちの心臓血管系にも大きな影響を及ぼすことが確認できます。

体温が下がると、免疫力が落ちます。

あらゆる疾病は、体温の低下が原因で発生します。体温の低下は「寒冷過敏症」といわれ、その症状は、まず心臓から離れた手や足が冷たくなります。そして、次第に体全体の温度低下に及ぶことがあります。

特に、外部の温度が低い時、手や足の温度が下がると、手足の毛細血管が収縮して体全体の血液循環を妨げます。

体温が 1℃下がっただけでも生命維持に必要な代謝活性が鈍くなります。

体温が 1℃ 下がっただけでも、3000種以上もの必須酵素が、生命維持に必要な機能を果たすことができなくなります。

体温が 1℃上がると、酵素活性が40%増加します。

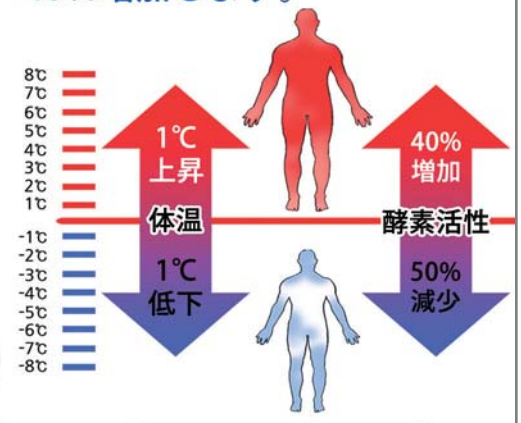

私たちの体温が1℃上昇しただけでも、体内の酵素活性は40%上昇し、一方、1℃下がると、酵素活性は50%以上も低下します。つまり、寒冷過敏症の人は免疫力が低下しているため、病気になりやすい傾向があります。

エクササイズは喜びだ。汗を流すことなしには幸福は得られない。(アーノルド・シュワルツェネッガー氏)

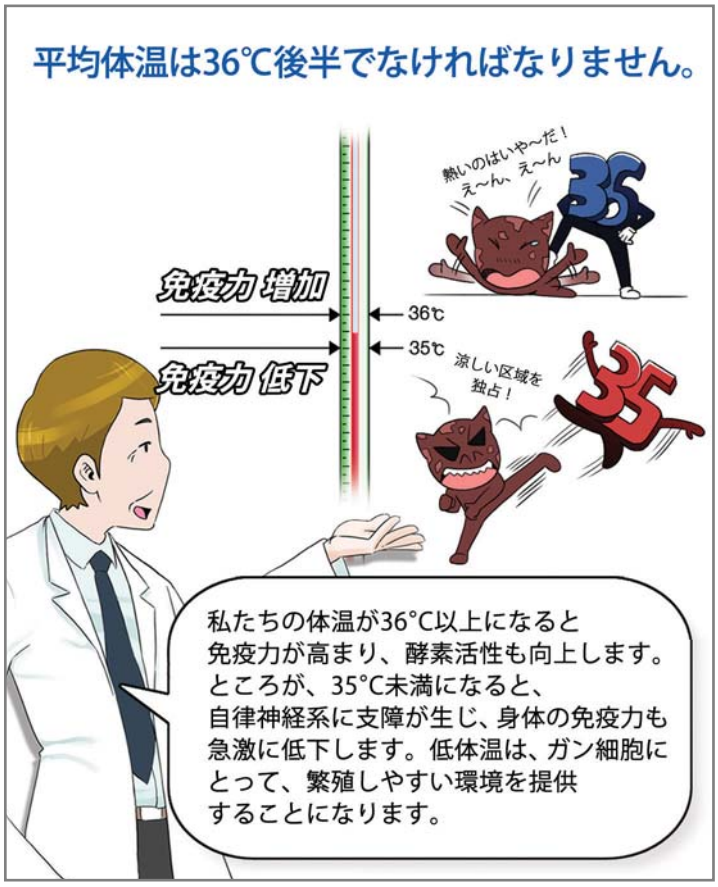

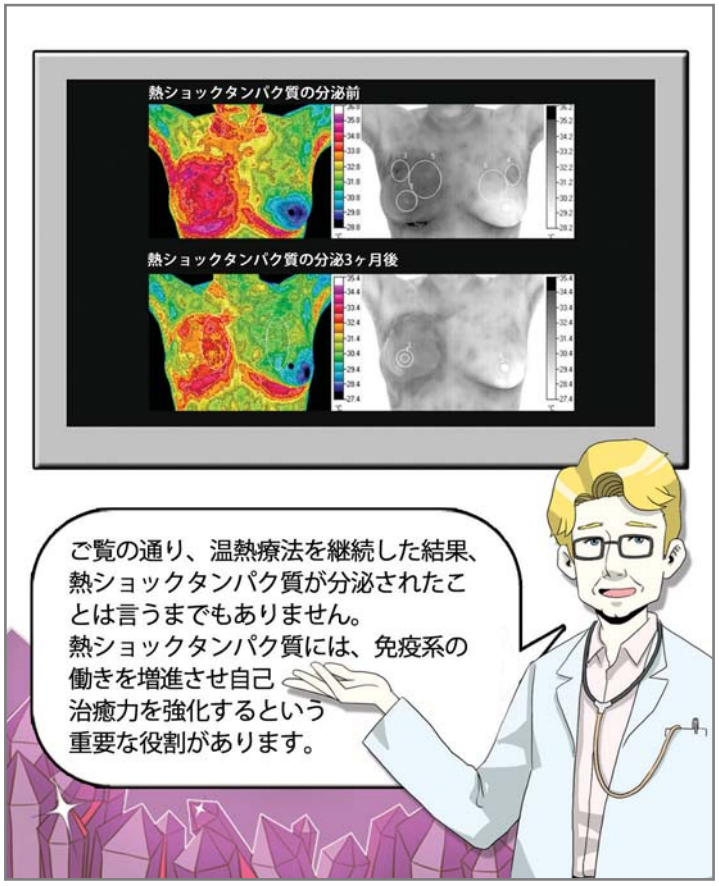

現代人の体内には、今日、50年前と比べて約1000倍以上の毒性重金属が存在する。(The Journal of the American Medical Association(JAMA 1974))

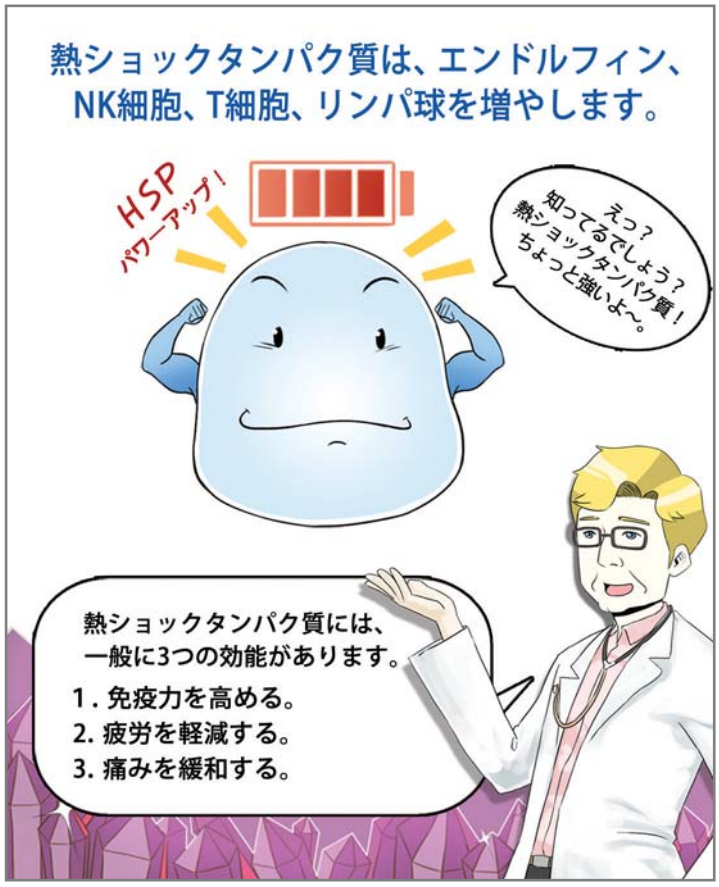

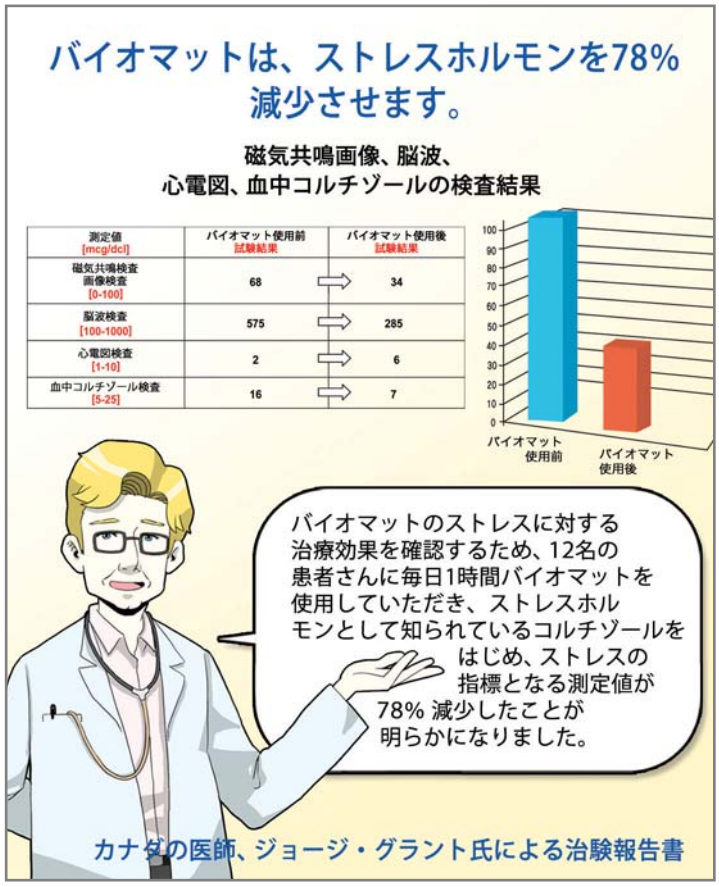

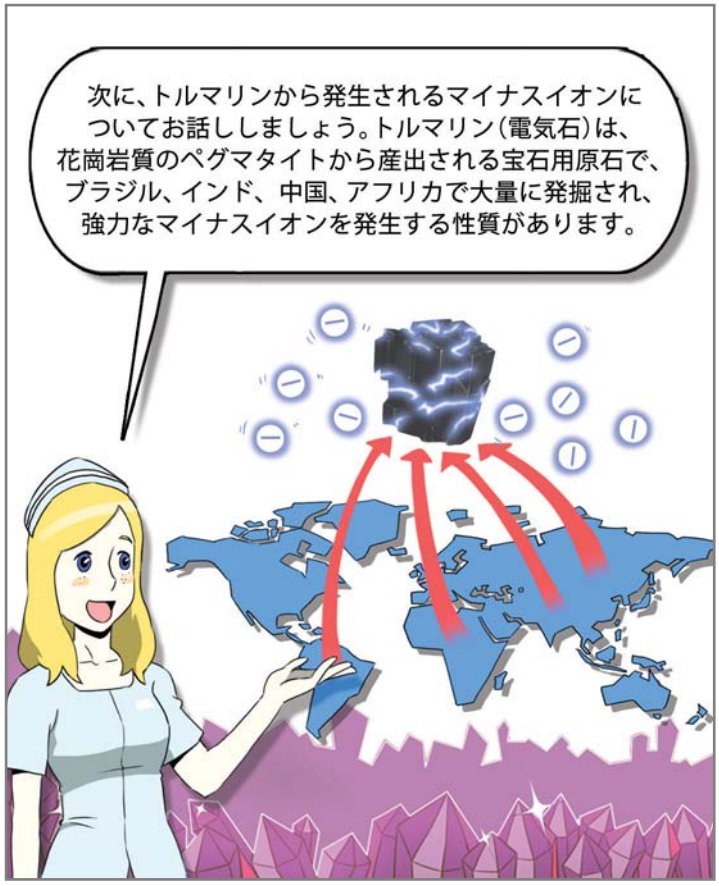

平均的な成人は、生涯を通して約6回ガンと激しい戦いを繰り広げる。

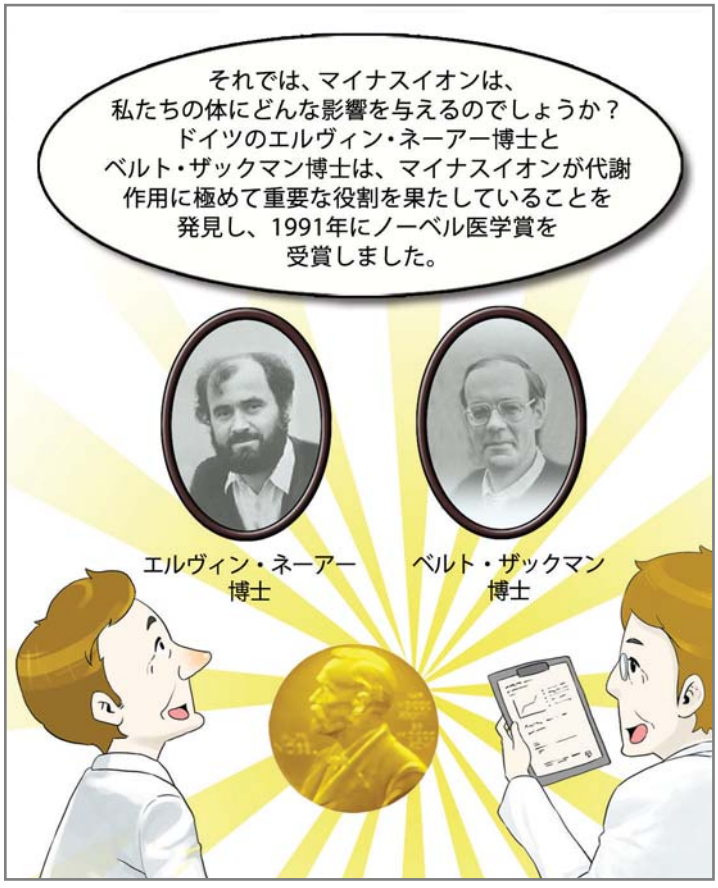

「悪玉菌を全滅し、老廃物を排出する。」まさに、免疫系が一日中行っている仕事。

この細胞チャネルを開くには、マイナスイオンが必要となります。

細胞内にマイナスイオンがないと、細胞チャネルは開けませんので、栄養素が全身に行き届かなくなって細胞の活性が悪くなり、その結果、痛みが生じます。

また、老廃物も排出されずに蓄積され、健康に悪い影響を及ぼすことになります。

私たちが痛みと感じるのはプラスイオンの電気信号を脳が感知するものです。バイオマットのマイナスイオンは呼吸や皮膚を通じて人体に吸収され、細胞の新陳代謝を促進し、活力を増進させ、痛みを緩和して、各種栄養素とエネルギーを体中に満遍なく広げる役割をします。また、血をきれいにし、神経安定と疲労回復にも効能があります。

〝マイナスイオンの働き〜！〟

バイオマットの本体と付属品

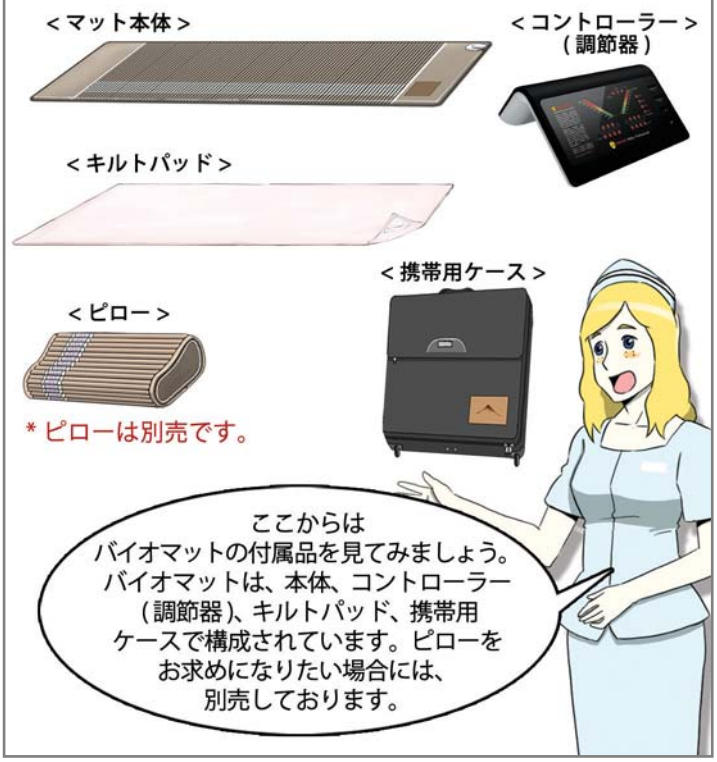

ここからはバイオマットの付属品を見てみましょう。バイオマットは、本体、コントローラー（調節器）、キルトパッド、携帯用ケースで構成されています。ピローをお求めになりたい場合には、別売しております。

バイオマットの種類

バイオマットには、キングサイズ、クイーンサイズ、シングルサイズ、プロ(BMP、プロフェッショナル)サイズ、ミニサイズがございます。キングサイズ、クイーンサイズ、シングルサイズは、標準ベッド用に設計されています。

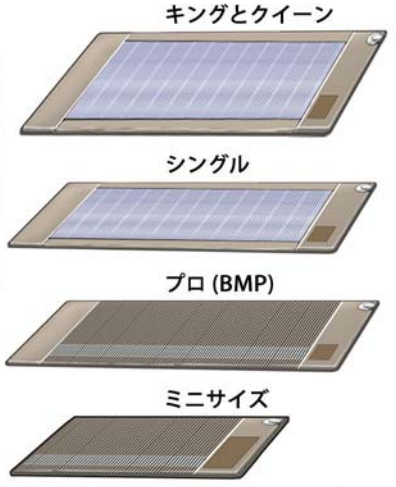

プロ(BMP、プロフェッショナル)サイズは、集中温熱療法用に設計されており、病院用ベッドやマッサージ用ベッドに最適です。ミニサイズのマットは、持ち運び簡単な旅行用として、また椅子のカバーに、さらに、温熱療法の際に、患者さんに掛けて使用することもできます。

免疫系は、正常な生理活動を補助しない細胞を見つけ出し、破壊する。

バイオマットコントローラー（調節器）の使用方法

まず始めに、マットをコントローラーに接続します。

ミニマットをコントローラーに接続します。

体内の細胞は、毎日約20億回分裂する。

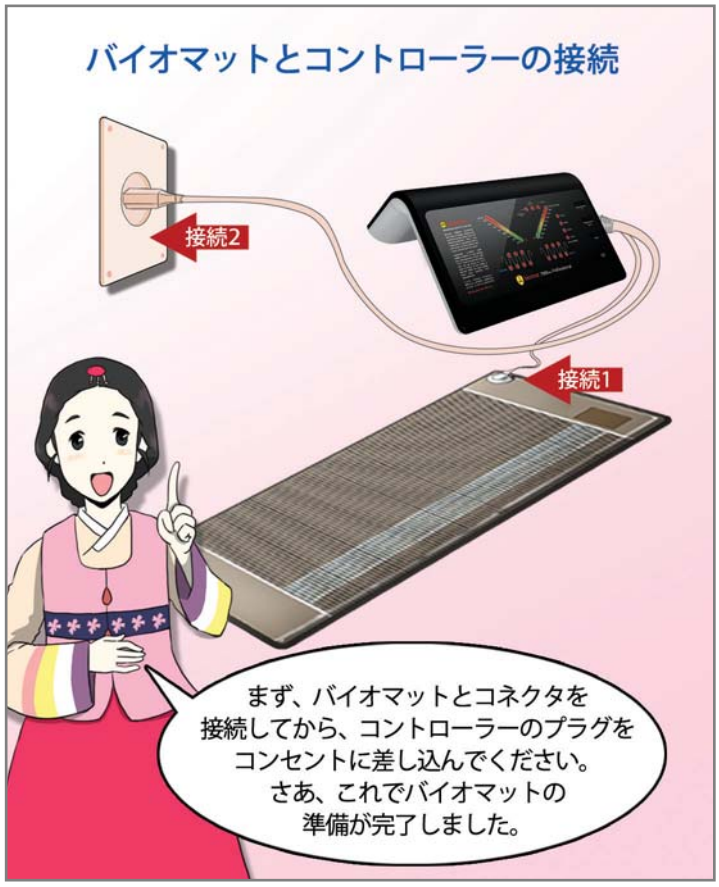

闘病中に血糖値が常に上昇するような食事制限は、山火事を消そうとしているときに横でガソリンをかけているのと同じだ。(ロレイン・デイ医師、1984年)

マイナスイオンと遠赤外線の調節

バイオマットのタイマー設定

バイオマットの温度の設定

バイオマットの電磁波遮断機能

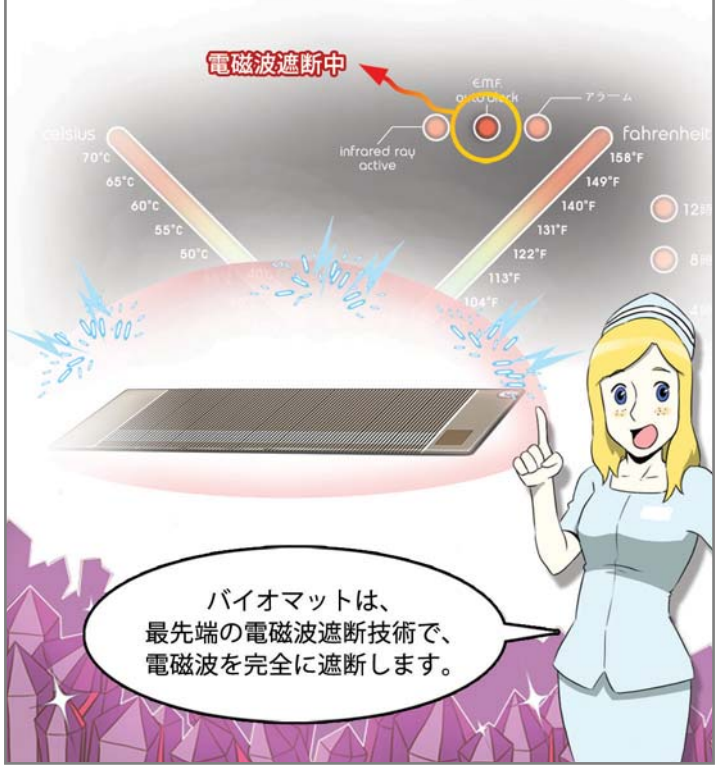

ストレスから逃れられないのなら、両手を縛って病気と戦っているようなものだ。

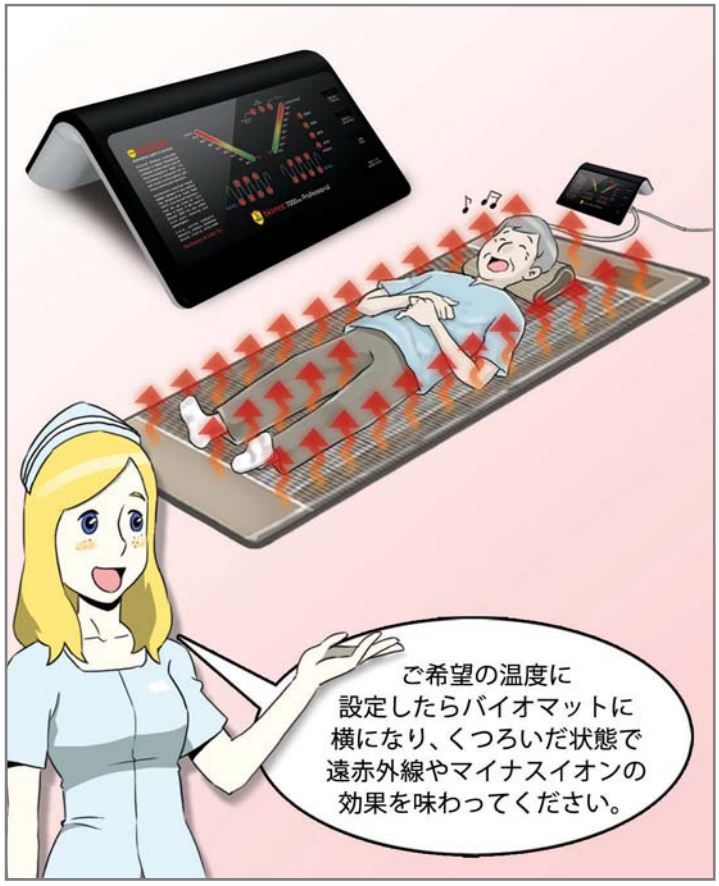

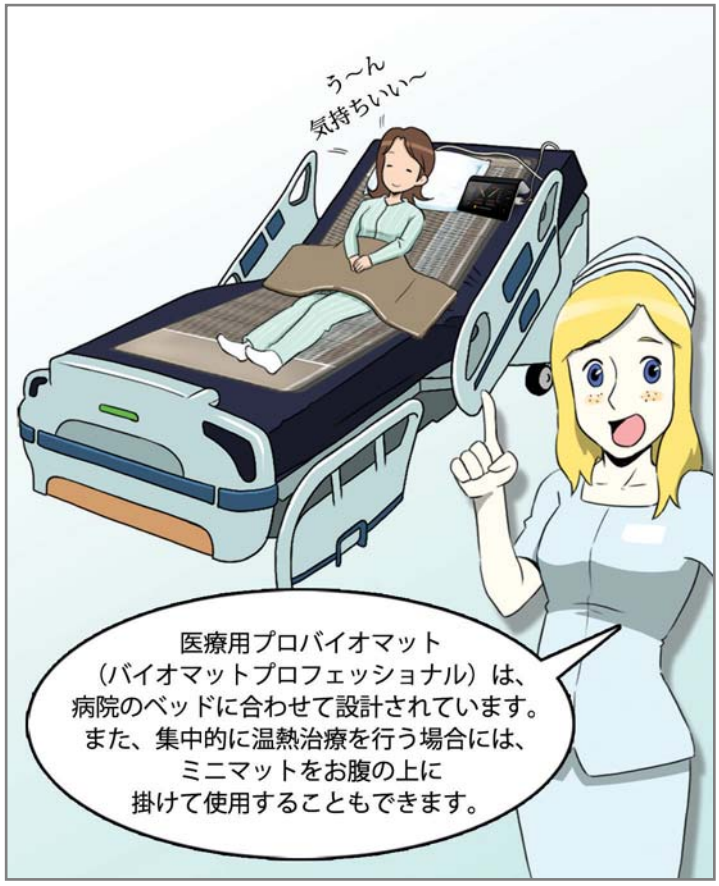

ストレスは、自分自身が自ら溜めるものである。憎悪感や嫌悪感、執着心や利己心など捨て去りなさい。

ミニマットの使い方

携帯用ミニマット

ミニマットは、ペットにもご利用になれます。

天然遠赤外線を放出するアメジストとトルマリンの枕

喜び、情熱、感謝、思いやりの心を抱たときこそ、神の生命が宿る。

集中療法を行う前には、水や良質の塩水を十分飲んでおいてください。

温熱療法を行う前に Detoxi(デトクシィ)イオン化塩の摂取が重要です。

細胞の浸透圧を調節
腎臓の機能を強化
体内のイオン活性を増強

Detoxi 300(デトクシィ 300)は、
温度1000℃で300時間以上加熱して生成された
イオン化塩です。バイオマットをご使用になる前には、
高濃度の塩酸を含んだイオン化塩の摂取をお勧めします。
イオン化塩は遠赤外線温熱療法の効用を高める働きがあり、
また、細胞や腎臓の浸透圧の調整を助けたり、
解毒作用を促進したりします。

集中療法の際のバイオマットの使い方

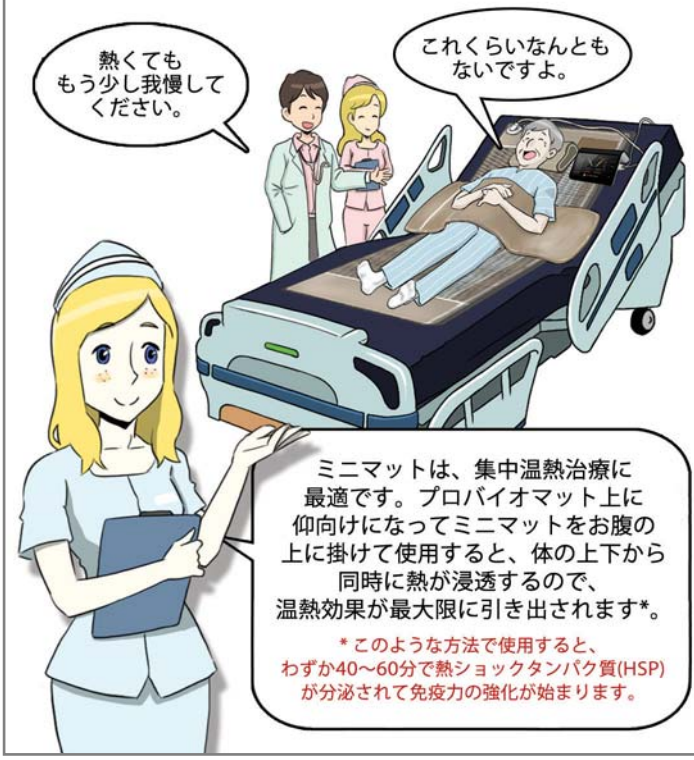

熱ショックタンパク質の生成

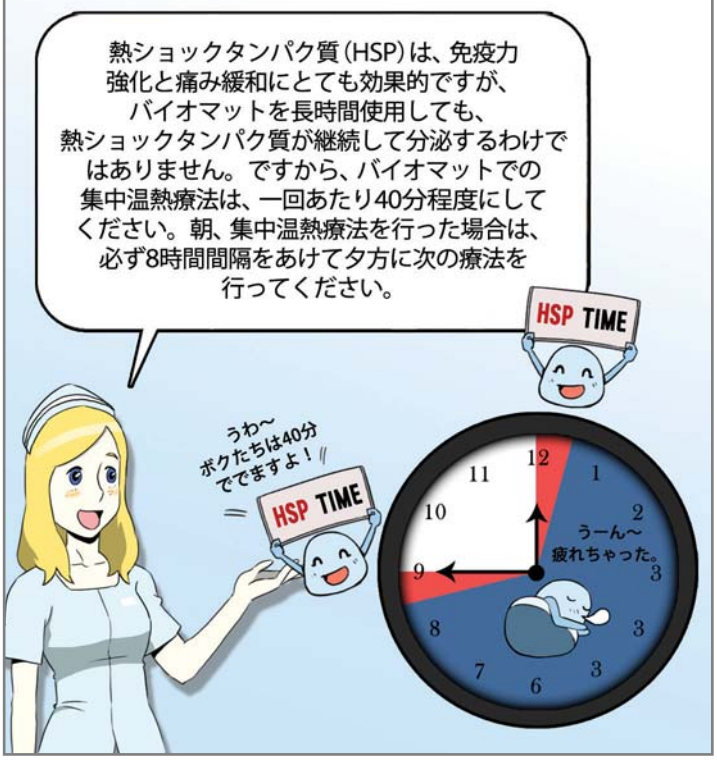

周囲に広がる美、音楽、笑いや喜びを感じよ。

集中温熱治療でバイオマットを高温または低温で使用する場合

バイオマットの使用上の注意

治癒反応は、解毒反応の始りです。心配ご無用。

湿気を避ける!

人が受ける愛の量は、最終的には、与える愛の量と同じ。(アビイ・ロード、1969年)

使用していない時の保管方法

バイオマットは、いつも同じように折りたたんで保管します。

バイオマットを立てて保管してはいけません。

洗濯やドライクリーニングは禁止です。

細胞はあなたと会話し、あなたの力になる。細胞を心から愛して。

キルトパッドは洗濯できます。

コントローラーを掃除する時には、注意してください。

他社製のコントローラーを使用しないでください。

コントローラーを覆ったり、バイオマットの上に置かないでください。

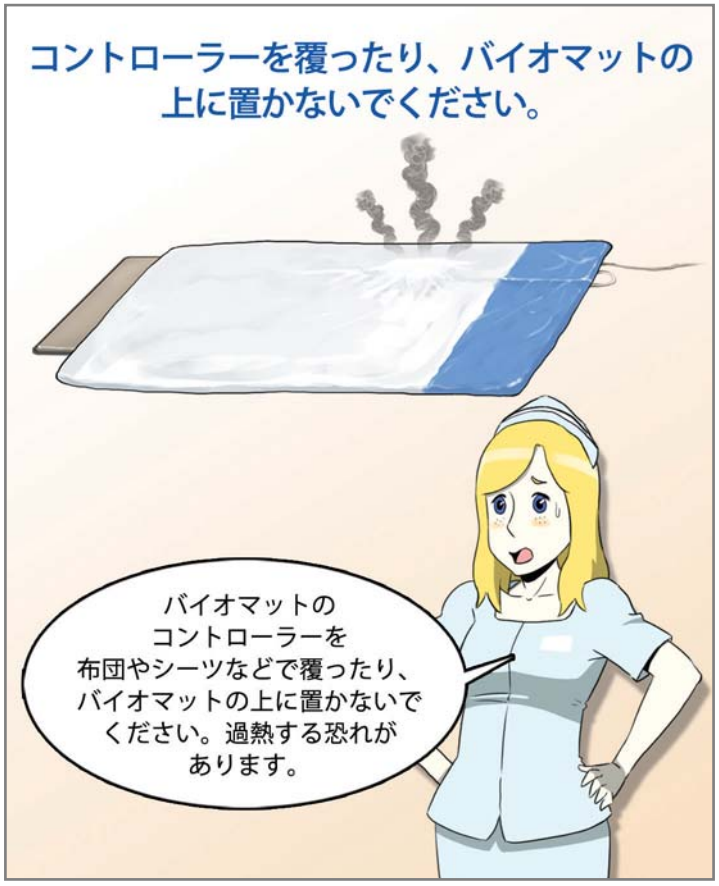

食事で治せない病は、どんな薬でも治せない。(ピポクラテス、紀元前460年)

マットの上で飛び跳ねないでください。

バイオマットには、
高感度センサーが内蔵されているので、
取り扱いには十分注意してください。
マットの上で飛び跳ねたり、衝撃を
与えたりすると、熱感知センサーが破損する
恐れがあります。また、尖ったもの
でマットを刺すと、耐水性を損ない、
感電する恐れがあります。

分解しないでください。

製品にトラブルが
生じた場合に、ご自分で
分解したり、修理したりし
ないでください。感電したり、
故障の原因になることがあります。
サービスのお問い合わせは、リッチウェイ&
ライフジャパンカスタマーセンター
までご連絡ください。
電話番号 092-575-1004。

電気コードが絡まっていないか、確認してください。

病院用の可動式
ベッドでバイオマットを
ご利用の際は、電気コードが
絡まっていないかを確認し、
また、マットを極端に曲げな
いよう注意してください。

バイオマットの上に重いものを乗せないでください。

バイオマット上のどの
部分にも重いものを置かないで
ください。重たいものを置くと、
オーバーヒートにより引火したり、
損傷が生じる恐れが
あります。

欲求不満や怒りは、万病の元。（フランスの格言）

国別の電圧に適した電気コードが必要です。ご確認ください。

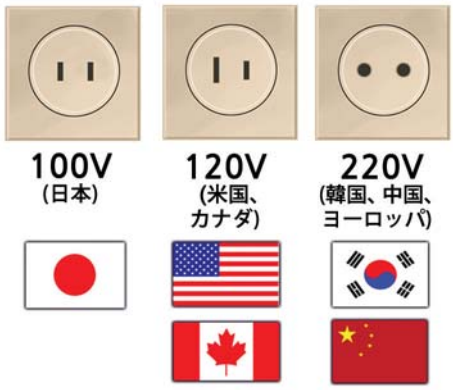

本製品は、220V用、120V用、100V用とそれぞれの国の規格に合わせて製造されています。ご注文の際にご利用になる国をお知らせいただければ、追加料金なしで適切な国用に特注生産致します。異なる電圧のコンセントに製品を接続すると、損傷の原因になることがあります。

電源プラグの接続

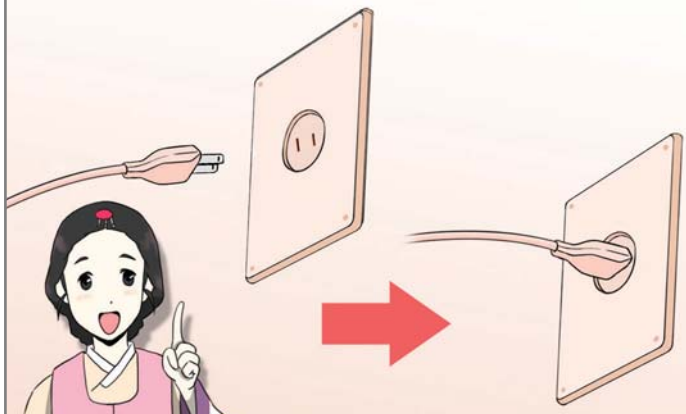

プラグを接続するときは、コンセントにしっかりと差し込んだか確かめてください。プラグがゆるいと、接触不良によりバイオマットが作動しないことがあります。

電源プラグ接続の際の注意事項

1つのコンセントにたくさんのプラグを接続しないでください。過重電流になって火災の原因となる恐れがあります。

濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。

濡れた手でコンセントに触れないでください。感電する可能性があります。

全ての取り巻く環境に感謝せよ。感謝の心は、体や心臓を治療する薬である。

国連(UN)から表彰されました。

リッチウェイバイオマットは、
世界中の人々の健康増進に
貢献していることが認められ、
国連から表彰されました。

THE UNITED NATIONS ASSOCIATION

CITATION OF SPECIAL MERIT

Dr Jeanna Chun Kim, C.E.O.
RichWay International, Inc.

In recognition of her outstanding contributions, dedication in promoting people's health.

She has also demonstrated strong leadership and commitments to Primary Health Care Enhancement for the benefit of the needy people and the society at large.

In witness thereof in recognition whereof, I have hereunto put my hand and affixed the Official Seal of the United Nations Association, on the 16th of June, 2009, in Jakarta, Indonesia.

Signed by

Prof. Kemal Boomsoi MD, Ph.D.
President
Jakarta, Indonesia

UNITED NATIONS ASSOCIATION HEADQUARTERS

FMANU
Palais des Nations
Room E8-24
1211 Geneva 10, Switzerland

WFUNA
United Nations Plaza
Room DC1-1177
New York, NY 10017, USA

ローマ法王ベネディクト16世聖下から祝福のメッセージをいただきました。

ローマ法王ベネディクト16世聖下
より祝福をお贈りします。
リッチウェイ インターナショナルの
会長であるジーナ チャン キム
(Jeanna Chun Kim)博士の人
類への尊い行為に祝福します。
貴殿は、国連から人類への貢献が認められ、
世界の人々の健康増進のリーダーとして
先導し、あふれんばかり天の恩寵
を喚起しました。ここに、引き続き聖母
マリアの恵みがあらんことを祈ります。

2009年5月6日
バチカン市国より

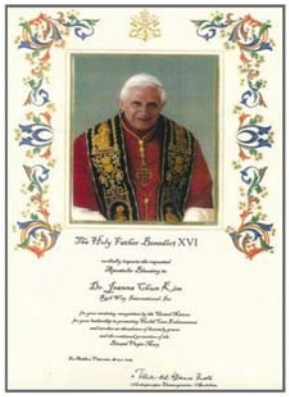

The Holy Father Benedict XVI

リッチウェイ社は、
アフリカのHIVに感染した子ども達を
救ったり、世界中の難病の治療に
貢献したことから、ローマ法王ベネディクト
16世聖下から祝福を受けました。

日本文化振興会の伏見総裁より表彰

リッチウェイインターナショナル
日本支社は、日本国民の健康増進に
寄与した功労が認められ、
日本文化振興会の伏見博明総裁より
表彰されました。

「ウォールストリートジャーナル(The Wall Street Journal)」で実業家に選ばれました。

THE WALL STREET JOURNAL 09/06/06

The National Republican Congressional Committee proudly recognizes its

BUSINESS ADVISORY COUNCIL

The NRCC's Business Advisory Council was formed to involve the country's top business leaders in the process of government reform. Their experience and knowledge, together with their get-it-done attitudes, will lead the way as we deal with the critical issues that affect economic stimulus in this country: tax reduction and simplification, affordable health care, regulatory relief and reducing frivolous lawsuits.

We recognize the following Honorary State Chairmen for their business and professional success, for the leadership they are already providing in their communities, and for their willingness to provide leadership to this important effort.

HAWAII
Calvin Kim

IDAHO

2006年に、
リッチウェイ社の
カルビン・キム(Calvin Kim)氏は、
米国で有名な経済新聞、
ウォール・ストリート・ジャーナルで、
優秀な実業家の一人として
選ばれました。

毎日一人ずつ許せば、毎日一つずつ病がなくなる。(イギリスの格言)

リッチウェイ社は、ホワイトハウスに招待されました。

米国FDAの510(k)審査で医療機器の認可を受けたバイオマット

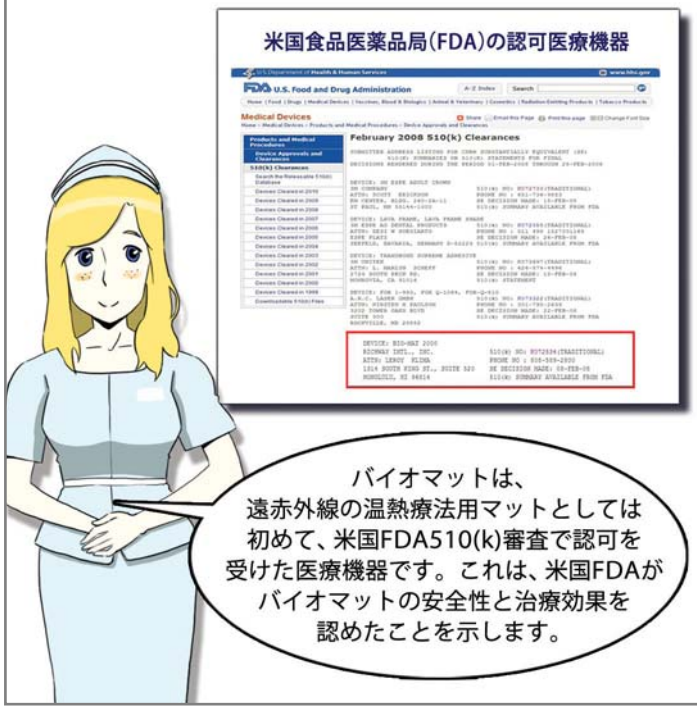

韓国食品医薬品安全所、韓国GMP、韓国電気安全公社の認可

日本の厚生労働省と日本電気用品試験所認可のバイオマット

闇に闇を追い払うことはできない。それができるのは光のみ。(マーティン・ルーサー・キングJr.)

温熱療法は数千年も前から用いられており、医者たちの間で発汗解毒療法と呼ばれる。

RICHWAY

biomat 7000mx

温熱療法の始祖

体温を上げるという治療法の
歴史は、2400年前から
始まっていた。

“私に熱を生み出す力をくれれば、
どんな病気でも治してみせる。”
ヒポクラテス（紀元前460年）

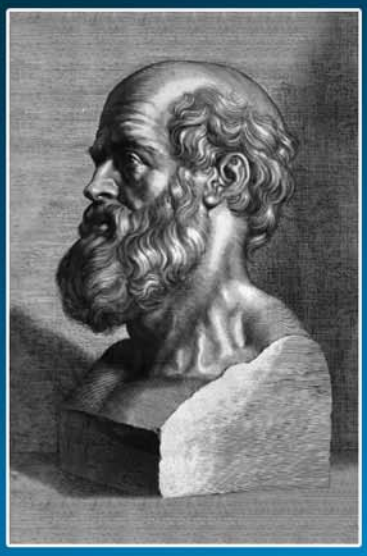

世界最初の技術

バイオテクノロジーに独自の革新：17層構成

❸ トカ層
強力なマイナスイオンと
磁気反応

キルリアン写真
マイナスイオン

**❺ 量子エネルギー
赤外線層**

キルリアン写真
アメジスト赤外線

❻ ナノ技術銅繊維層
電磁波遮断用銅
ファイバー層

ヒデオ博士のダイヤグラム
微小エネルギーの増幅用
カーボン層